

携帯端末の品質向上、テストコストの削減を実現

MX702003A は、携帯端末の評価を目的としたテストの自動化を実現するPC ソフトウェアです。MD8480A /B W-CDMA シグナリングテスト、新栄電子計測器株式会社製 ロボットアームと本ソフトを組み合わせることで、人が実際に操作して行ってきた携帯端末の機能確認やソフトウェア検証などの検査を自動化することが可能となります。

特長

携帯端末の品質向上

複数のテストシナリオを連続実行できるので、より多くのテストケースを実施することができます。

人手による携帯端末操作では不可能な、微妙なキー入力タイミングが要求されるテストも容易に実現できます。


特定の手順やタイミングによって生じるバグを、検出時と同じ条件で簡単に再現できます。

テストコストの削減

テストの自動化により作業時間が短縮され、テストコストの削減につながります。

連続テストで機器の稼働率を上げることにより、資産を有効に活用できます。

システム構成例

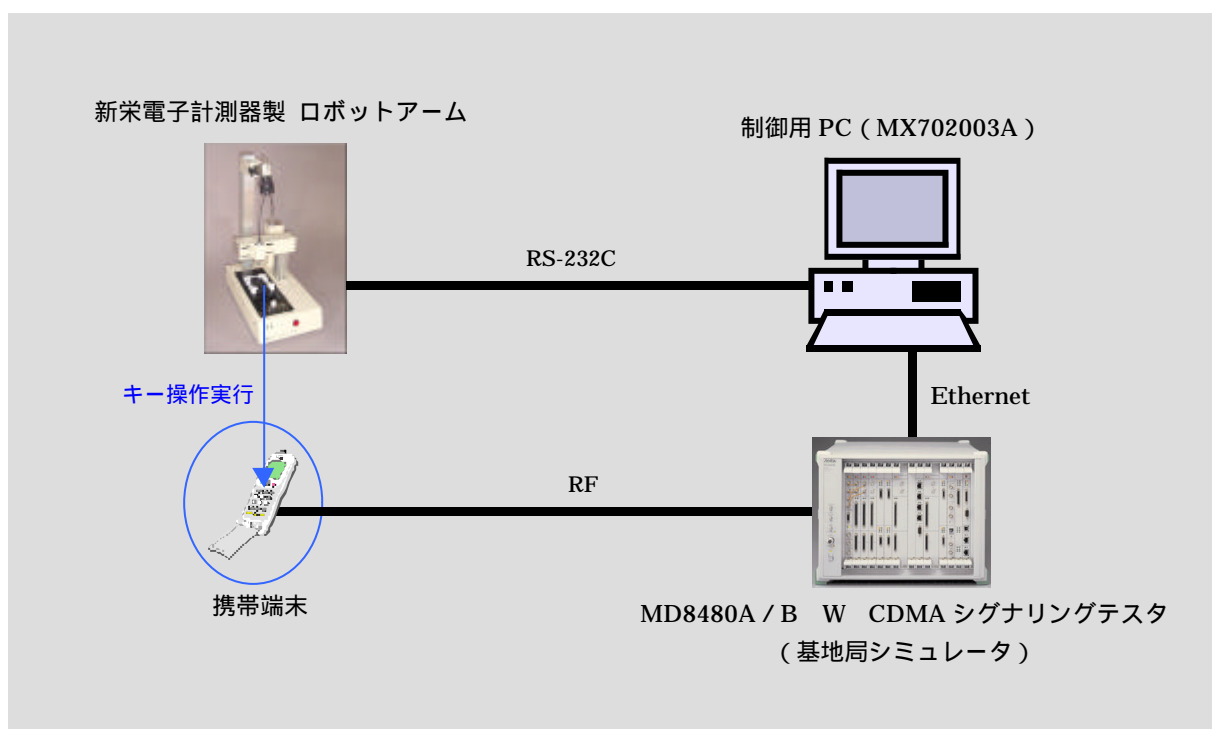

必要機器と推奨性能

MX702003A W-CDMA 用
携帯端末テストソフトウェア
(PC ソフトウェア)

必要アイテム

MD8480A / B W-CDMA シグナリングテスト¹
携帯端末操作治具
(新栄電子計測器株式会社製 AF-80)
制御用 PC (推奨スペックは右記)
LAN ケーブル
RS-232C ケーブル
RF ケーブル

1 MD8480A / B ソフトウェアは、
MX848000 コントロールソフトウェア: V5.10 以上
Firmware: V5.10 以上
FPGA: V5.00 以上
が必要となります。

また、MD8480A / B W-CDMA シグナリングテ
スタには、テスト内容に応じたオプションボードおよびオ
プションソフトウェアを装備している必要があります。

制御用 PC の必要スペック

推奨システム
IBM PC-AT 互換機
OS: Windows 2000 Professional SP4 日本語版
CPU: Pentium4 1GHz 以上
メモリ: 256M バイト以上
ハードディスク: 2G バイト以上の空き容量
ディスプレイ: 800 × 600 ピクセル以上の解像度
256 色以上
その他: CD-ROM ドライブ
USB ポート
LAN ポート (10/100BASE-T)
シリアルポート (RS-232C)
キーボード・マウス
.NET Framework 1.1 必要

Microsoft®, Windows®, Windows 2000®は、米国 Microsoft Corporationの米国その他の国における登録商標です。Pentium®は、Intel Corporationの登録商標です。本文中のその他の登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。

オーダリング・インフォメーション

ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。

形名・記号	品名	備考
MX702003A	- 制御ソフトウェア - W-CDMA 用 携帯端末テストソフトウェア - 標準付属品 - CD-R : 1 枚 ライセンスキー : 1 個	PC ソフトウェア MX702003A ソフトウェア
W2438AW	MX702003A 取扱説明書 : 1 部	

Anritsu

お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社

<http://www.anritsu.co.jp>

本社	TEL 046-223-1111 243-8555	神奈川県厚木市原名1800
第一営業部	046-296-1202 243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第二営業部	046-296-1203 243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第三営業部	03-5741-3258 146-0092	東京都大田区下丸子2-27-3
第四営業部	046-296-1205 243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第五営業部	03-5741-3251 146-0092	東京都大田区下丸子2-27-3
防衛グループ		
北海道支店	011-231-6229 060-0042	札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル
東北支店	022-266-6131 960-0811	仙台市青葉区一番町2-3-20 第3日本オフィビル
関東支店	046-600-5651 330-0061	さいたま市中央区新都心4-1 FSKビル
千葉営業所	043-351-8151 261-0023	千葉市美浜区中環1-7-1 住友ケミカルエンジニアリングセンタービル
関東支店	029-825-2900 300-0034	土浦市港町1-7-23 ホープビル1号館
新潟支店	025-243-4777 950-0816	新潟市米山3-1-63 マルヤマビル
中部支店	052-582-7281 450-0002	名古屋市中央区名駅3-22-4 みどり名古屋ビル
関西支店	06-6391-0111 532-0003	大阪市淀川区高島4-1-14 社友生命新大阪北ビル
東大阪支店	06-6787-6677 577-0066	東大阪市高井田本通7-7-19 昌利ビル
中国支店	082-263-8501 732-0052	広島市東区光町1-10-19 日本生命光町ビル
四国支店	087-861-3162 760-0055	高松市観光通2-2-15 第2ダイヤビル
九州支店	092-471-7855 812-0016	福岡市博多区博多駅前1-3-11 博多南ビル

製造元

アンリツエンジニアリング株式会社

計測器の使用法、その他についてのお問い合わせは下記まで。

計測サポートセンター

TEL: 0120-827-221, FAX: 0120-542-425

受付時間/9:00~17:00、月~金曜日(当社休業日を除く)

E-mail: MDVPGST@cc.anritsu.co.jp

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国内務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■このカタログの記載内容は2004年6月21日現在のものです。

00c/COT

R70 古紙配合率70%再生紙を
使用しています。